

微振分析出報告格式

量測開始時間 2004 年 5 月 8 日 04:20:24

取樣頻率 (Sampling Rate) 200 Hz

量測時間長度 60.00 秒



Trigger Mode 自動

Delay Time 10.00 秒

Channel 總數 32

圖形資料為:CH 1 E-W(FAB 4F)

取樣視窗長(sec):5

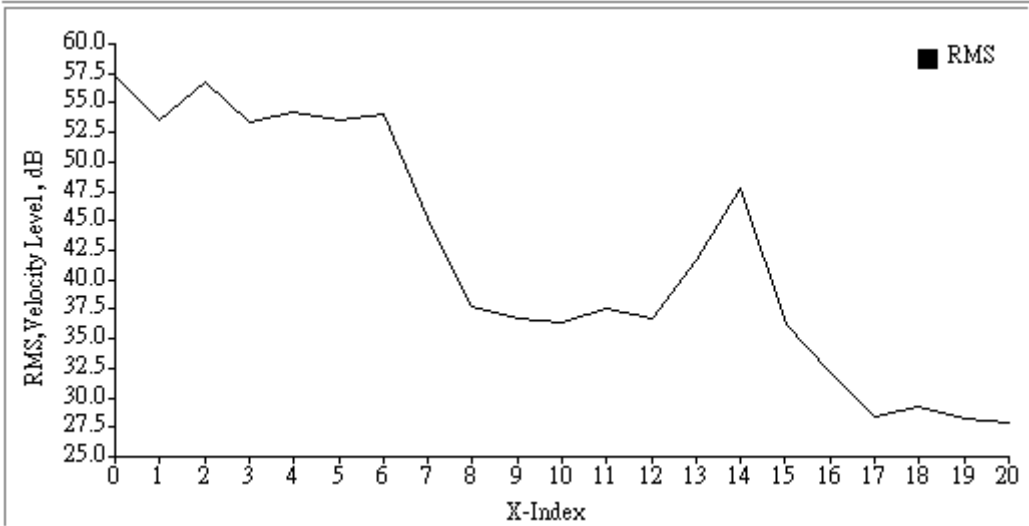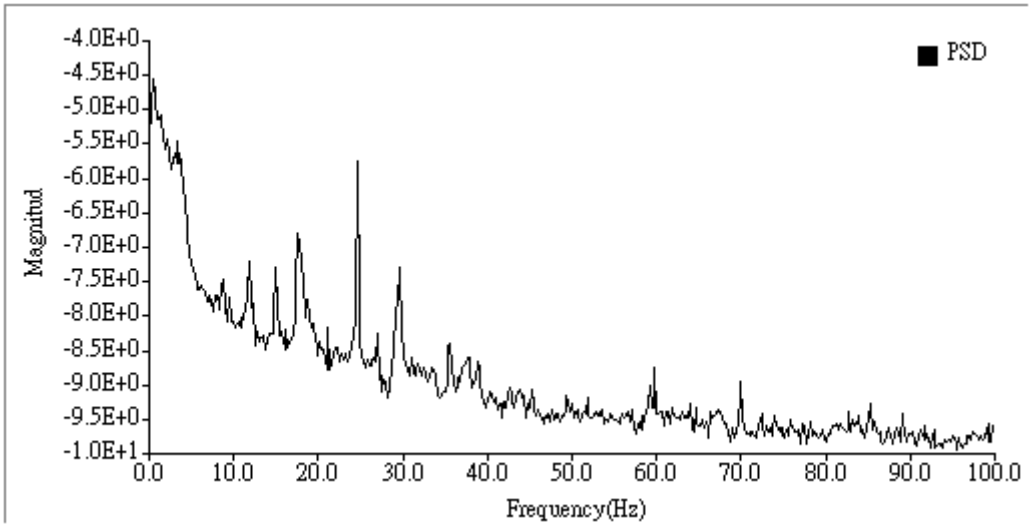

X 軸與 RMS 中心頻率-Index

座標標示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中心頻率(Hz)	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00	6.30	8.00	10.00	12.50	16.00	20.00	25.00	31.50	40.00	50.00	63.00	80.0	100.0	125.0	160.0	200.0